

PRODUKTINFORMATION

MAGNETOSCOP 1.070

Portables Magnetometer



Merkmale

- Portables, mikroprozessor-gesteuertes Magnetometersystem
 - Sonden zur Messung der Magnetischen Flussdichte als Absolut- oder Differenzwert (Gradient)
 - Taster zur Messung der Relativen Permeabilität μ_r gemäß IEC 60404-15 und ASTM A342/A342M
 - USB Schnittstelle zur Datenübertragung
 - SD Karte zur Speicherung von Messdaten und Parametern
 - Spitzenwert-Erkennung /-Speicherung
 - Einstellbare Schwellen für Grenzwerte
 - Optische und akustische Alarmsignale
 - Einzel- und Serienmessungen
 - Editierbare Mess- und Prüfabläufe mit graphischer Bedienerführung
 - Batterie- oder Netzbetrieb
 - PC Software für Datenanalyse und Dokumentationserstellung
-

Messverfahren

- Förster-Sonden (Fluxgates)- (Absolut / Gradient)

Applikationen

- Langzeitüberwachung des magnetischen Umfeldes, z.B. vor Installation magnetisch sensibler Geräte und Anlagen
- Kontrolle von Materialien und daraus gefertigten Komponenten auf mögliche magnetische Restfelder/Remanenz
- Lokalisieren ferritischer Einschlüsse in Edelstählen bzw. NE-Materialien
- Oberflächenprüfung zur Erkennung von Einschlüssen und Magnetischer Remanenz (z.B. Lagerschalen)
- Messung der Relativen Permeabilität im Rahmen der Qualitätskontrolle von Edelstählen und niedrig-permeablen (amagnetischen) Legierungen
- Nachweis der Materialveränderung (Aufkohlung, Abbau von Beschichtungen, Korrosion, Gefügeumwandlungen) durch Permeabilitäts-Vergleichsmessung

Komponenten

Messgerät und Sonden/Taster werden kalibriert, mit Zertifikat ausgeliefert. Geräte- und Kalibrierparameter sind in der jeweiligen Komponente elektronisch hinterlegt. Sonden/Taster werden bei Anschluss vom Messgerät automatisch erkannt.

Messgerät MAGNETOSCOP 1.070



- Kompaktes, leichtes Messgerät
- 3,5“ Farbdisplay
- Übersichtliche Menüstruktur zur Bedienerführung
- Datenloggerfunktion
- Anschluss von 1-Achs-Magnetfeldsonden, 3-Achs-Magnetfeldsonden als Option
- Anschluss von Permeabilitäts-Messtastern
- Triggereingang
- Temperatur- Messkanal
- USB, Mini USB und SD Karten Schnittstellen
- Stromversorgung über Batterien, Akkus oder Netzteil

Sonde PD-100-100



- Differenzsonde mit 100 mm Sensorabstand
- 1 nT bis 100 μT Messbereich
- Zum Vermessen größerer lokaler Magnetfeldanomalien
- Kompensation des Erdmagnetfeldes bzw. großer Störer aus dem Fernfeld
- Raumabhängigkeit bei Bewegung im homogenen Erdfeld:< 50 nT

Sonde PD-100-20



- Differenzsonde mit 20 mm Sensorabstand
- 10 nT bis 100 µT Messbereich
- Zum Vermessen kleiner lokaler Magnetfeldanomalien
- Detektion lokal begrenzter Remanenzen
- Kompensation des Erdmagnetfeldes bzw. großer Störer aus dem Fernfeld
- Raumanhängigkeit bei Bewegung im homogenen Erdfeld < 100 nT

Sonde PFD-100



- Sensorpaar zur wahlweisen Anordnung als Absolut- oder Differenzsonde mit variablem Sensorabstand
- 1 nT bis 100 µT / 200µT Messbereich bei Absolut- / Differenzanordnung
- Zur Bestimmung magnetischer Restfelder bzw. Remanenz von Einzelkomponenten, wobei die Sonde fixiert und auf Null kompensiert sein muss
- Bei Differenzanordnung und paralleler Sensorsausrichtung Kompensation des Erdmagnetfeldes bzw. großer Störer aus dem Fernfeld
- Amagnetische Sondenhalterung als Option

Sonde PF-1000



- Sonde zur Absolutfeldmessung
- 10 nT bis 1 mT Messbereich
- Die Sensorelemente sind parallel in axialer Richtung des Sondengehäuses eingebaut
- Zur Bestimmung von Magnetfeldern nach Richtung und Betrag
- Zur Bestimmung magnetischer Restfelder bzw. Remanenz von Einzelkomponenten, wobei die Sonde fixiert und auf Null kompensiert sein muss

Taster PP-2-5




- Messtaster zur Bestimmung der Relativen Magnetischen Permeabilität μ_r an Halbzeugen und Werkstücken
- Messbereich μ_r 1,00000 bis 2,00000
- „Permeability Meter“ Methode nach IEC 60404-15 bzw. „Flux Distortion Method“ nach ASTM A342/A342M, Methode 4.
- Rückführbar kalibriert auf nationale Standards der PTB-Braunschweig, nach IEC 60404-15 “Solenoid and magnetic moment” Methode, ASTM A342/A342M Methode 1, H=30 kA/M

Software

MAGDATA TRANSFER-Software


Software zur Kommunikation zwischen PC und MAGNETOSCOP.

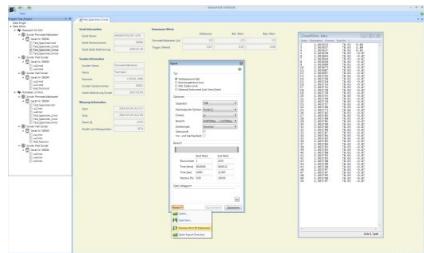

- Messdaten vom MAGNETOSCOP laden
- Messdatensätze in andere Formate konvertieren (.txt, .csv, .xml, .tdm (LabVIEW™),...)
- Software-Updates auf das MAGNETOSCOP laden


MAGDATA VIEW-Software

Umfangreiche Software zur Visualisierung von Messdaten – maximal 16 Kanäle gleichzeitig.

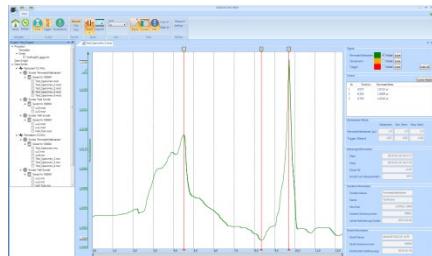

- Messdaten selektieren und reduzieren
- Messdaten visualisieren (Oszilloskop, Werteliste, ...)
- Verarbeiten von dynamischen Messverfahren mit Trigger-Information (Weg, Zeit)
- Statistische Auswertung von Messreihen
- Reporterstellung und Druck
- Vorlagen für Mess- und Prüfabläufe erstellen und auf das MAGNETOSCOP laden

MAGDATA HOTSPOT-Software

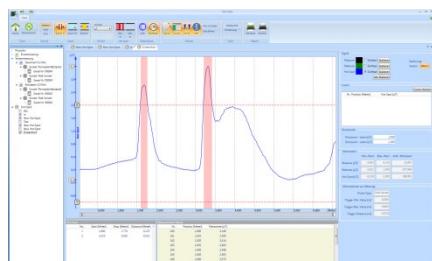


- Messdaten selektieren und reduzieren
- Messdaten visualisieren (Oszilloskop, Werteliste,...)
- Verarbeiten von dynamischen Messverfahren mit Trigger-Information (Weg, Zeit)
- Verarbeitung von Referenzmessungen zur Offset-Kompensation
- Definition und Darstellung von Grenzwerten sowie Markierung magnetischer Anomalien
- Reporterstellung nach API Spec 7

Technische Daten


Messbereich	0,1 nT bis 1 mT μ_r 1,00000 bis 2,00000
Auflösung	24 Bit ADC
Messunsicherheit, Feldmessung	1,5 % des Messwertes
Messunsicherheit, Permeabilitätsmessung	5 % des Messwertes
Umgebungstemperatur	0 bis +40 °C
Schutzklasse	IP54
Abmessungen Messgerät	212 × 102 × 41 mm (L × B × H)
Displaygröße	3,5"
Gewicht Messgerät inkl. Batterien	0,62 kg
Batterietyp	4 Stück Mignon, AA, LR6 Alkaline oder NiMH

Sonden/Taster - Abmessungen und Lage der Sensoren


PD-100-100

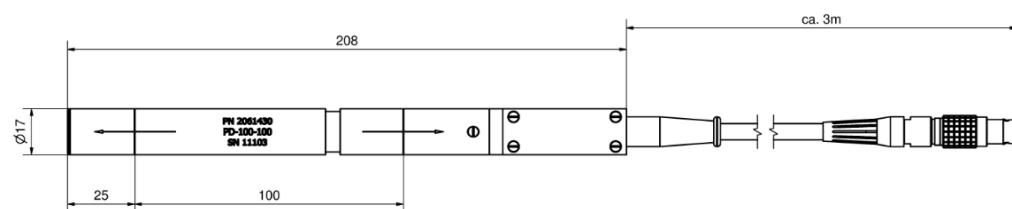


PD-100-20

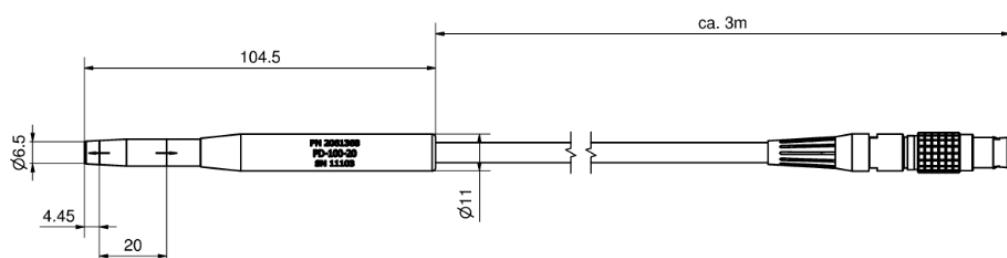


PFD-100

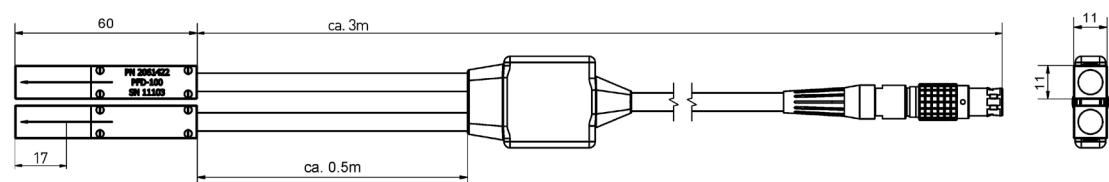

PF-1000

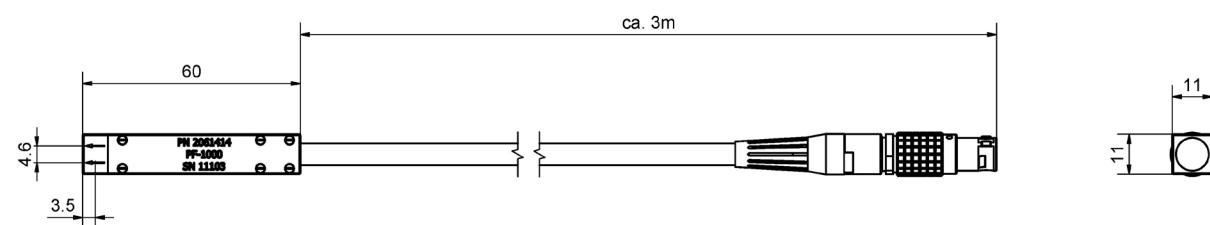

PP-2-5

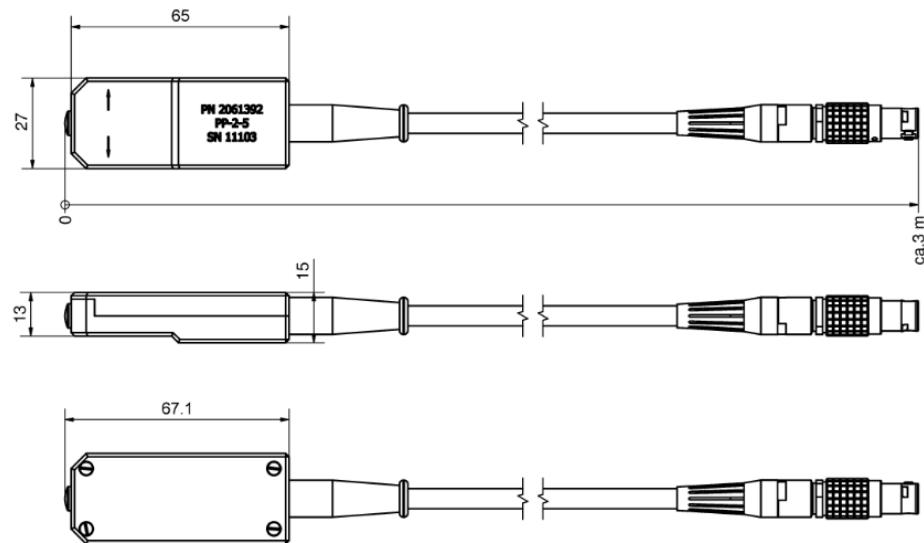

Funktionspakete

MAGNETOSCOP 1.070 – Feld- und Differenzmessung

- Grundausstattung
- Messgerät MAGNETOSCOP 1.070
 - Koffer
 - Steckernetzteil
 - MAGDATA TRANSFER Software
 - USB Kabel
 - 4 Batterien

Sonde PFD-100

Sondenhalter

MAGNETOSCOP 1.070 – Feldmessung

Grundausstattung

Sonde PF-1000

MAGNETOSCOP 1.070 – Differenzmessung – 20 mm

Grundausstattung

Sonde PD-100-20

MAGNETOSCOP 1.070 – Differenzmessung – 100 mm

Grundausstattung

Sonde PD-100-100

MAGNETOSCOP 1.070 – Permeabilitätsmessung

Grundausstattung

Taster PP-2-5

Referenzstandard μ_r 1,05

Adapter

Zubehör

Stromversorgung

Steckernetzteil	5 VDC, 2,4 A, 100 – 240 VAC
Akku	NiMH 1,2 V, Mignon, AA, HR6, 2.850 mAh
Ladegerät zum Akku 1,2V	100 – 240 VAC, 50/60 Hz
Akkupack (extern)	5 VDC, 2,4 A, 10.000 mAh
Ladegerät zum Akkupack	5 VDC, 2,2 A, 100 – 240 VAC, 50/60 Hz

Kabel

Triggerkabel	5 m lang
Sondenverlängerungskabel	5 / 15 m

Referenzstandards

Referenzstandard	μ_r 1,005/ 1,025/ 1,05/ 1,2 für Taster PP-2-5 kalibriert auf nationale Standards der PTB-Braunschweig, nach IEC 60404-15 "Solenoid and magnetic moment" Methode, ASTM A342/A342M Methode 1, H=30 kA/M
Adapter zur präzisen Sondenzentrierung auf dem Referenzstandard	für Taster PP-2-5

Software

MAGDATA Transfer	Systemvoraussetzungen: 32 / 64 Bit Betriebssysteme Ab Windows 7
MAGDATA View	
MAGDATA Hotspot	

Sonstiges Zubehör

Tragetasche	Für Messgerät und externen Akkupack
Gürteltasche	Zum externen Akkupack

Impressum



Institut Dr. Foerster GmbH & Co. KG
In Laisen 70
72766 Reutlingen
Deutschland

t +49 7121 140-0
f +49 7121 140-488
info.de@foerstergroup.com

MAGNETOSCOP 1.070
Ausgabe: 11/2025

Änderungen vorbehalten.
® Eingetragenes Warenzeichen in verschiedenen
Ländern weltweit

foerstergroup.com

Warenzeichen:

LabVIEW™ ist ein Warenzeichen von National Instruments

Microsoft® Windows® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation